



#### Austria

Abbott Ges.m.b.H.  
Diagnostics  
Perfektastrasse 86  
1230 Wien  
Tel. (+43) 1 89 122 0  
Fax (+43) 1 89 122 44

#### Belgium/Luxembourg

Abbott S.A./N.V.  
Parc Scientifique  
Rue du Bosquet 2  
BE-1348 Louvain-la-Neuve  
Tel. (+32) 10 47 53 11  
Fax (+32) 10 47 53 34

#### Croatia

Abbott Representative Office  
Planinska bb  
10000 Zagreb  
Tel. (+385) 1 23 50 560  
Fax (+385) 1 24 41 331

#### Czech Republic

Abbott Laboratories s.r.o.  
Hadovka Office Park  
Evropska 2590/33d  
160 00 Praha 6  
Tel. (+420) 2 672 92 111  
Fax (+420) 2 672 92 233

#### Denmark

Abbott Laboratories A/S  
Diagnostics  
Smakkedalen 6  
2820 Gentofte  
Tel. (+45) 39 77 00 00  
Fax (+45) 39 77 01 99

#### Egypt (MEN)

ADD Egypt  
13 Sheikh Sharawi St.  
Sheraton Area/Heliopolis  
Cairo  
Tel. (+20) 2 2 68 49 31  
Fax (+20) 2 2 68 49 21

#### Finland

Abbott Oy  
Diagnostics  
Pihatörmä 1A  
02240 Espoo  
Tel. (+358) 9 75 18 42 1  
Fax (+358) 9 75 18 41 50

#### France

Abbott France S.A.S.  
12, Rue de la Couture  
Silic 203  
94518 Rungis Cedex  
Tel. (+33) 1 45 60 25 00  
Fax (+33) 1 45 60 04 98

#### Germany

Abbott GmbH & Co. KG  
Max-Planck-Ring 2  
65205 Wiesbaden  
Tel. (+49) 6122 580  
Fax (+49) 6122 581244

#### Greece

Abbott Laboratories  
(Hellas) S.A.  
Diagnostics  
512 Vouliagmenis Avenue  
174 56 Alimos, Athens  
Tel. (+30) 2 10 99 85 171  
Fax (+30) 2 10 99 58 361

#### Hungary

Abbott Kft.  
Globe 13 Irodahaz  
Teve utca 1/a-c. 6 em.  
1139 Budapest  
Tel. (+36) 1 465 2100  
Fax (+36) 1 465 2199

#### Ireland

Abbott Diagnostics  
4051 Kingswood Drive  
Citywest Business Campus  
Dublin 24  
Tel. (+353) 1 469 1560  
Fax (+353) 1 469 1565

#### Italy

Abbott S.p.A.  
Abbott Diagnostics  
Via Mar della Cina 262  
00144 Rome  
Tel. (+39) 06 52 99 11  
Fax (+39) 06 52 99 14 36

#### Latvia

Abbott Laboratories S.A.  
Latvian Representative Office  
34, Bruinieku str.  
Riga, LV-1011  
Tel. (+371) 7 31 48 23  
Fax (+371) 7 31 48 38

#### Netherlands

Abbott B.V.  
Siriusdreef 51  
2132 WT Hoofddorp  
Tel. (+31) 23 55 44 500  
Fax (+31) 23 55 44 577

#### Norway

Abbott Norge AS  
Nesøyveien 4, Postboks 123  
N-1376 Billingstad  
Tel. (+47) 81 55 99 20  
Fax (+47) 66 98 39 09

#### Poland

Abbott Laboratories  
Poland Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 41  
02-672 Warsaw  
Tel. (+48) 22 606 10 50  
Fax (+48) 22 606 10 80

#### Portugal

Abbott Laboratórios Lda.  
Diagnósticos  
Rua Cidade de Córdova, 1A  
Alfragide  
2720-100 Amadora  
Tel. (+351) 21 472 72 00  
Fax (+351) 21 472 72 00

#### Romania

Abbott Laboratories  
Representative Office Romania  
(Diagnostics Division)  
No 133, Calea Serban Voda  
Et. 1, Corp B, Sector 4  
70517 Bucharest  
Tel. (+4021) 3 36 86 00  
Fax (+4021) 3 36 86 42

#### Russian Federation

Abbott Laboratories S.A.  
9, Dmitrovsky per.  
103031 Moscow  
Tel. (+7) 0952 5842 70  
Fax (+7) 0952 5842 71

#### Saudi Arabia

Mediserv  
P.O.B. 40758  
Riyadh 11511  
Tel. (+966) 14 6122 26  
Fax (+966) 14 6133 39

#### Slovak Republic

Abbott Laboratories  
Slovakia s.r.o.  
Trnavská cesta 70  
82102 Bratislava 2  
Tel. (+421) 2 444 54 188  
Fax (+421) 2 444 54 420

#### South Africa

Abbott Laboratories (Pty) Ltd.  
Abbott Place  
219 Golf Club Terrace  
Constantia Kloof  
Roodepoort 1709  
Tel. (+27) 11 858 2000  
Fax (+27) 11 858 2130

#### Spain

Abbott Científica S.A.  
Costa Brava, 13  
28034 Madrid  
Tel. (+34) 91 337 3400  
Fax (+34) 91 734 9664

#### Sweden

Abbott Scandinavia AB  
Gårdsvägen 8, 169 70 Solna  
Tel. (+46) 8 5465 6700  
Fax (+46) 8 5465 6800

#### Switzerland

Abbott AG  
Diagnostics  
Neuhofstrasse 23  
6341 Baar  
Tel. (+41) 41 768 44 44  
Fax (+41) 41 768 44 50

#### Turkey

Abbott Laboratuvarlari  
Ekinciler Cad. Hedef Plaza  
Kat 4 Kavacyk-Beykoz  
34810 Istanbul  
Tel. (+90) 216 5 38 74 00  
Fax (+90) 216 4 25 09 78

#### United Arab Emirates

Abbott Laboratories S.A.  
API World Tower  
off. no. 403/4th floor  
Sheikh Zayed Road  
Dubai  
Tel. (+971) 43 327 862  
Fax (+971) 43 327 904

#### United Kingdom

Abbott Laboratories Ltd.  
Diagnostics  
Abbott House, Norden Road  
Maidenhead, Berkshire  
SL6 4XF, England  
Tel. (+44) 16 28 7840 41  
Fax (+44) 16 28 6442 05

# AxSYM Progesteron





## Charakterystyka testu


- Czułość analityczna lepsza lub równa 0,2 ng/mL (0,6 nmol/L) poprawia przydatność diagnostyczną.
- Dobra powtarzalność w całym zakresie pomiaru zwiększa rzetelność wyników.
- Metoda z reakcją dwustopniową zapobiega efektowi Hook'a i zmniejsza potencjalne ryzyko interferencji.

## Informacja o produkcie

<b>Metoda</b>	Enzyμο-immunochemiczna z użyciem mikrocząstek (MEIA)		
<b>Zakres pomiaru</b>	0,0 - 40,0 ng/mL (0,0 - 127,2 nmol/L)		
<b>Kalibratory</b>	0,0, 0,7, 2,0, 7,0, 20,0, 40,0 ng/mL (0,0, 2,2, 6,4, 22,3, 63,6, 127,2 nmol/L)		
<b>Stabilność krzywej kalibracji</b>	Standardowo 2 tygodnie		
<b>Stabilność odczynnika w aparacie</b>	łącznie 224 godziny w aparacie		
<b>Odczynniki i kalibratory</b>	Gotowe do użycia		
<b>Rodzaj próbki</b>	Surowica lub osocze (rodzaje próbek: z heparyną sodową lub trójpotasowym EDTA)		
<b>Wydajność</b>	Do 84 oznaczeń na godzinę		
<b>Czas uzyskania pierwszego wyniku</b>	21 minut		
<b>Czułość analityczna</b>	≤0,2 ng/mL (≤0,6 nmol/L)		
<b>Liniiowość rozcieńczeń</b>	Ogólny średni odzysk 100,1%		
<b>Powtarzalność</b>	<b>Numer panelu</b>	<b>Średnie stężenie</b>	<b>Całkowity % CV</b>
	1	0,59 ng/mL (1,88 nmol/L)	8,9 - 11,7
	2	1,03 ng/mL (3,28 nmol/L)	5,9 - 7,3
	3	5,71 ng/mL (18,16 nmol/L)	3,4 - 5,8
	4	21,83 ng/mL (69,42 nmol/L)	4,5 - 6,8
<b>Wartości referencyjne (ng/mL)</b>	<b>Płeć</b>	<b>Wart. minimalna</b>	<b>Wart. maksymalna</b>
	<i>Mężczyźni</i>	<0,2 ng/mL (<0,6 nmol/L)	3,37 ng/mL (10,72 nmol/L)
	<i>Kobiety w okresie menstruacji</i>		
	Faza folikularna	0,27 ng/mL (0,86 nmol/L)	2,61 ng/mL (8,30 nmol/L)
	Faza lutealna	3,28 ng/mL (10,43 nmol/L)	38,63 ng/mL (122,84 nmol/L)
	Faza poowulacyjna	5,25 ng/mL (16,70 nmol/L)	38,63 ng/mL (122,84 nmol/L)
	<i>Kobiety w okresie menopauzy</i>	<0,2 ng/mL (<0,6 nmol/L)	0,82 ng/mL (2,61 nmol/L)
	<i>Kobiety w ciąży</i>		
	Pierwszy trymestr	12,26 ng/mL (38,99 nmol/L)	81,80 ng/mL (260,12 nmol/L)
	Drugi trymestr	11,11 ng/mL (35,33 nmol/L)	81,40 ng/mL (258,85 nmol/L)
	Trzeci trymestr	39,30 ng/mL (124,97 nmol/L)	387,80 ng/mL (1233,20 nmol/L)

## Porównanie metod\*

**Doskonała korelacja i zgodność z systemem Bayer ACS:180 – dla wszystkich badanych próbek**

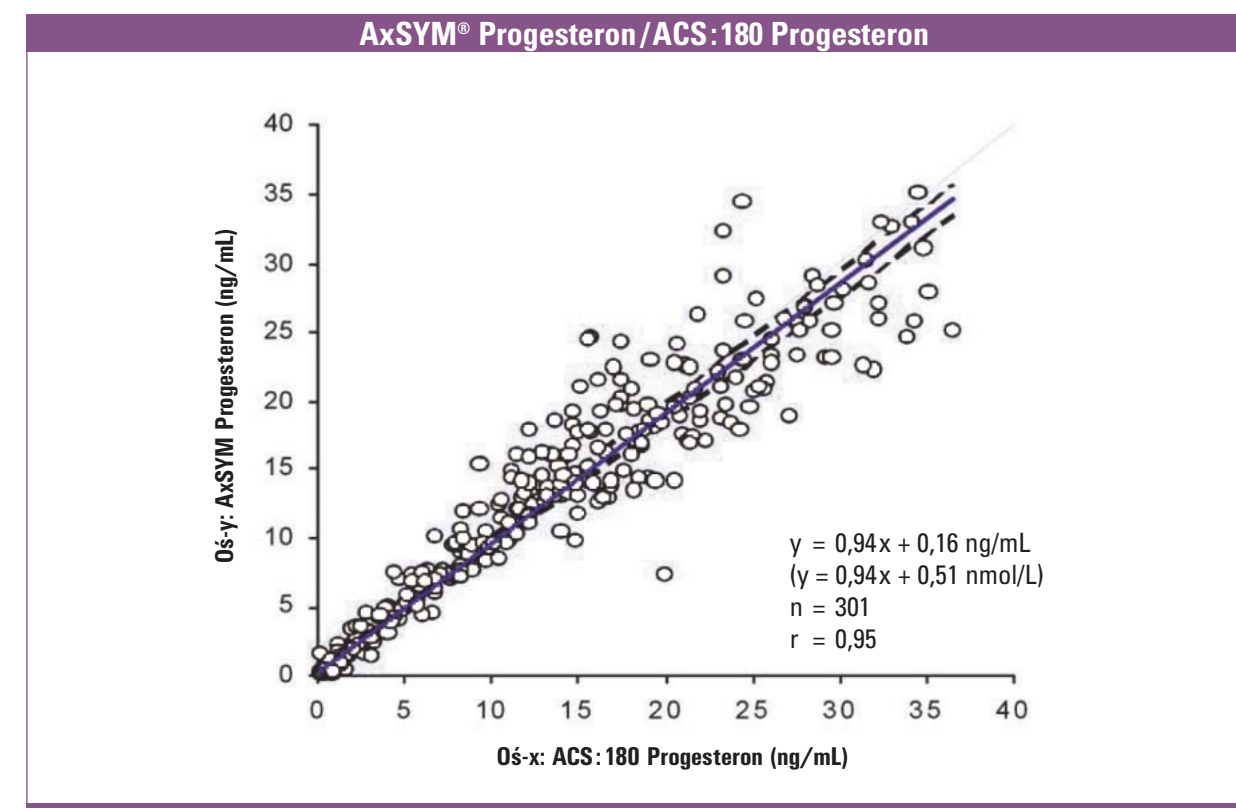

\* Passing – Bablock

## Informacje niezbędne do zamawiania

Opis produktu	Numer katalogowy
AxSYM Progesterone Reagent Kit (100 testów)	7A64-22
AxSYM Progesterone Calibrator Kit (6 poziomów)	7A64-01
AxSYM Progesterone Control Kit (3 poziomy)	7A64-10
AxSYM Fertility/Pregnancy-dyskietka	3D51-03 lub wyższy